

AF 101 gelb

AF 101

AF 101


OC 602 gelb

2 OC 604 spez.

GVO spez.
(FD 5)

OA 150

OA 150

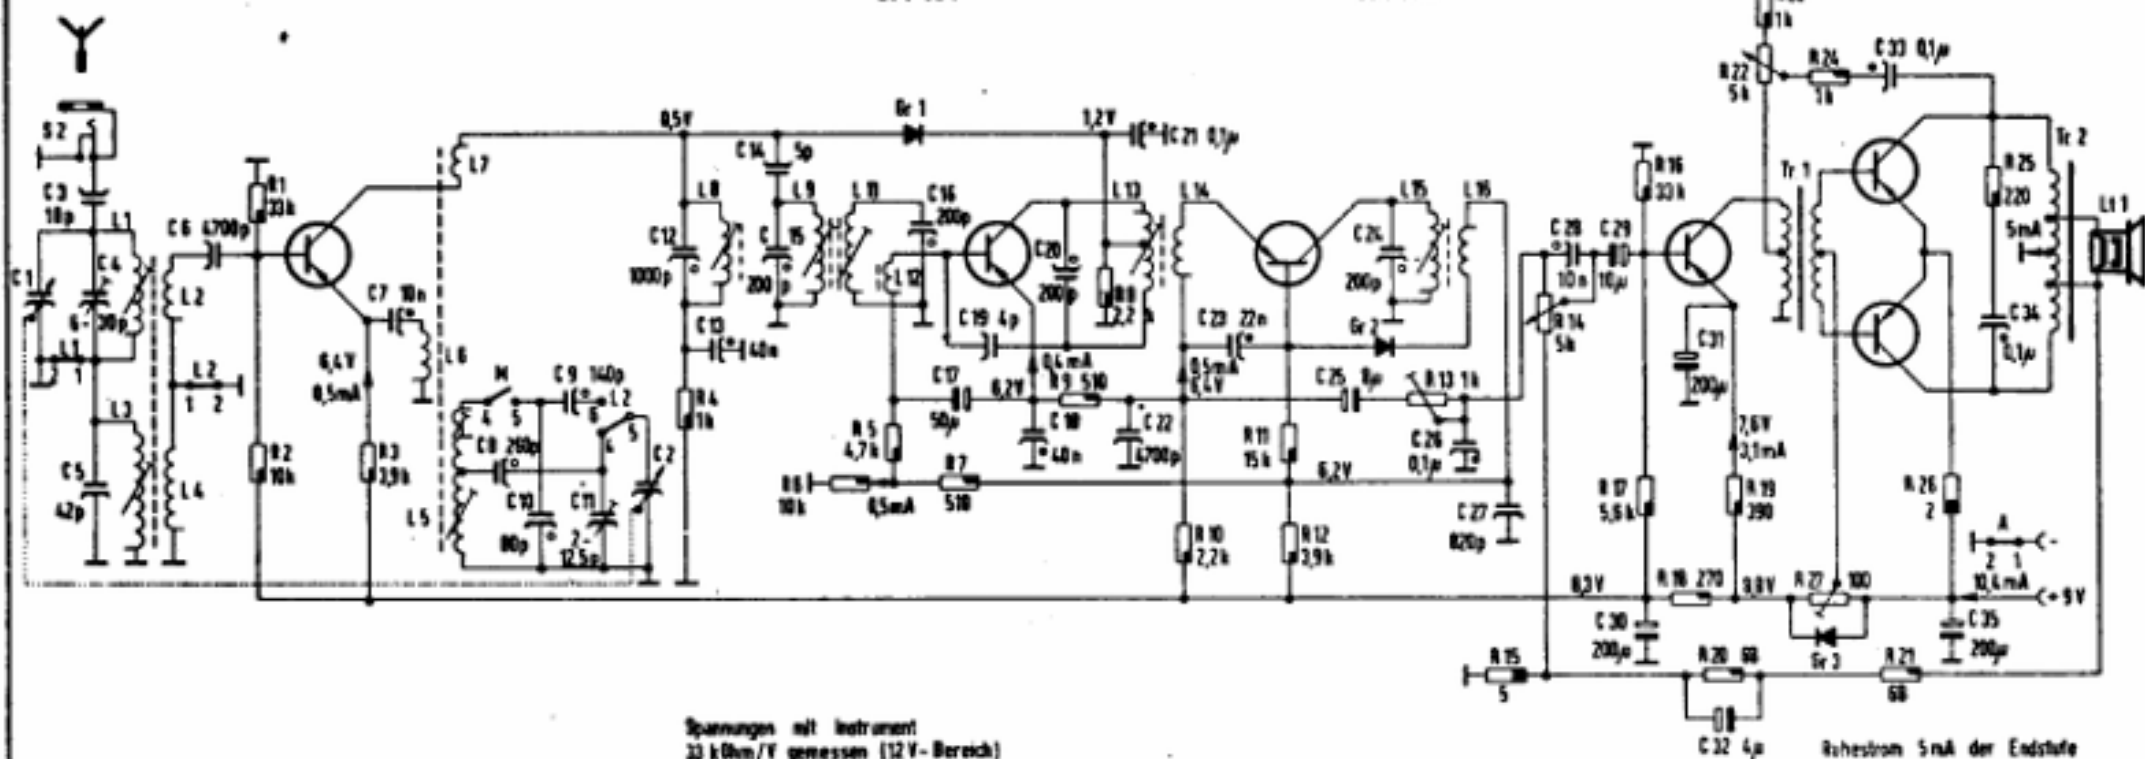


Spannungen mit Instrument
20 kOhm/V gemessen (12V-Bereich)
ohne Sender und Lautstärke-Regler
auf 0

Spannung an Basis jeweils
um 0,1-0,2V geringer als am Emittor

Ruhestrom 5mA der Endstufe
mit R27 einstellen

LOEWE OPTA „LORD“ 5930

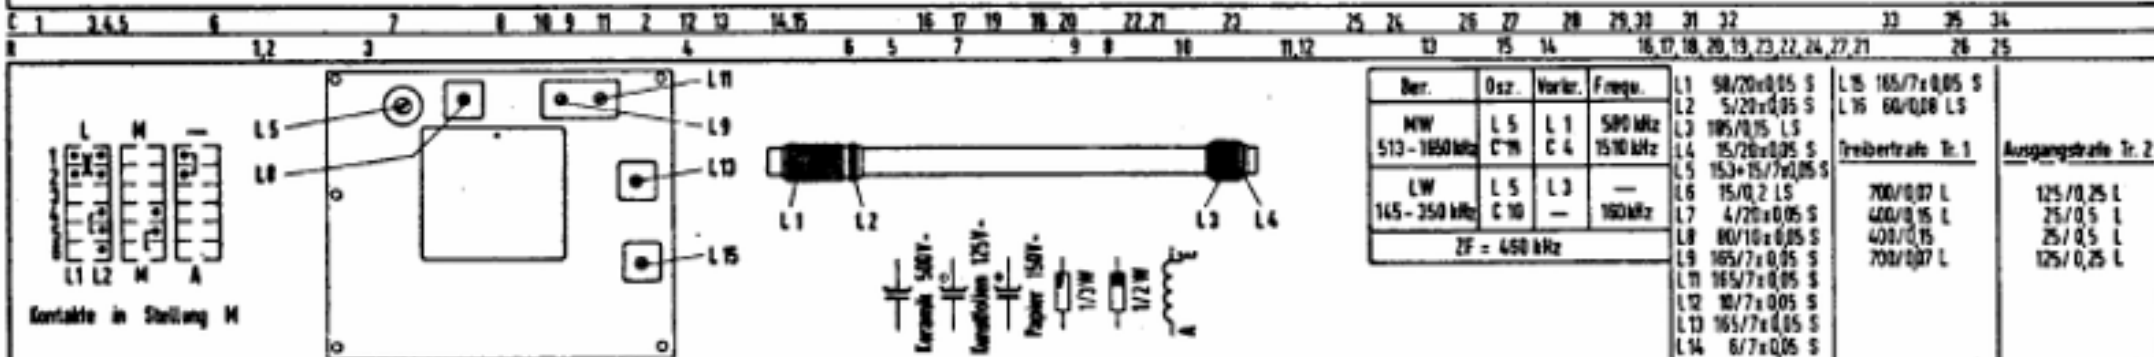

Kontakte in Stellung M